




FreeStyle
Libre 3

Glukosewerte jede
einzelne Minute –
kombiniert mit dem
mylife Loop System
zur automatisierten
Insulinabgabe –
für ein einfacheres
Diabetesmanagement.



75 
mg/dL


Verhilft Ihnen zu einer besseren Glukosekontrolle. Das mylife Loop System zur automatisierten Insulinabgabe ist freigegeben für die Verwendung mit FreeStyle Libre 3.

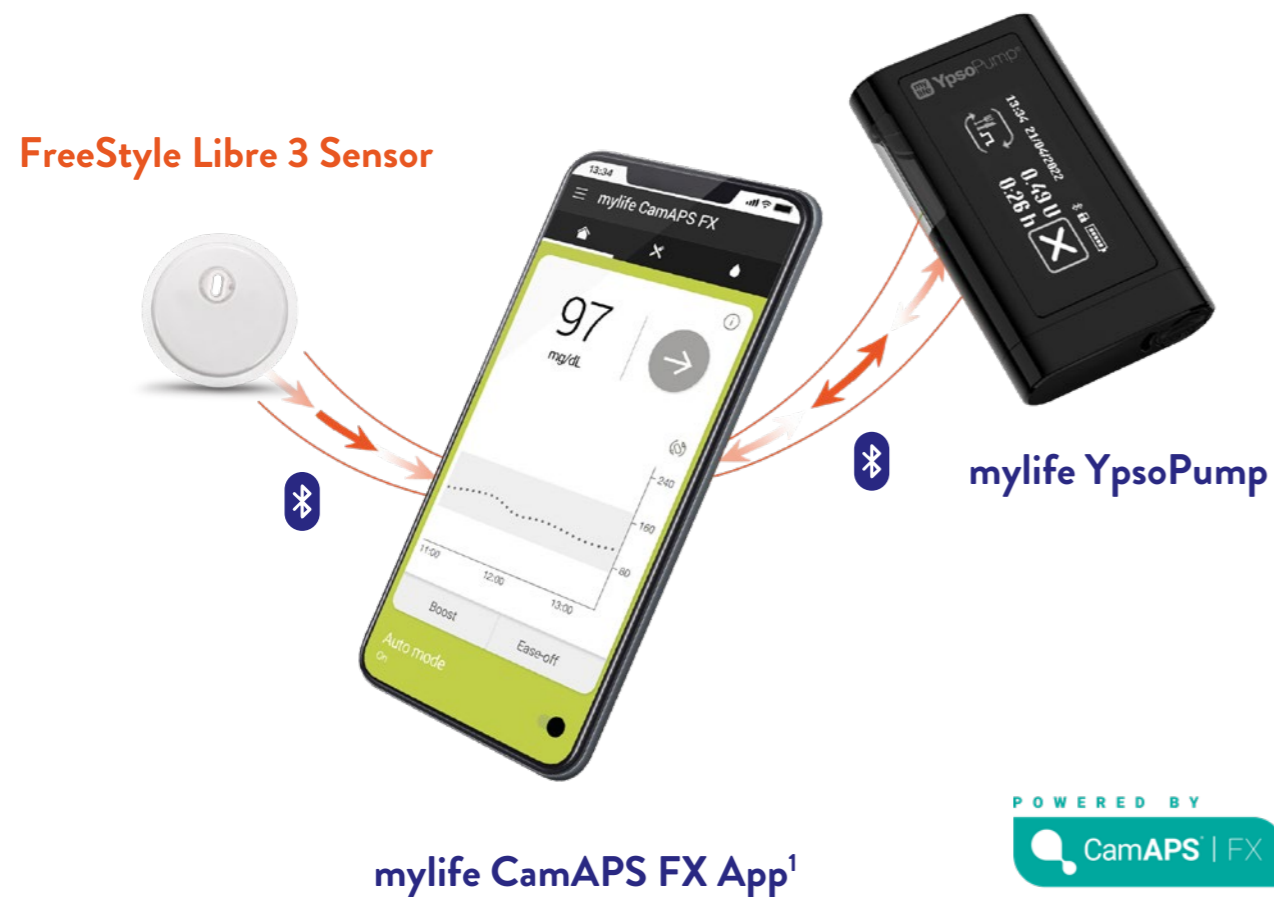

Der **FreeStyle Libre 3 Sensor** liefert Glukosewerte jede einzelne Minute und ist für die Verwendung mit dem mylife Loop System zur automatisierten Insulinabgabe freigegeben.

Das mylife Loop System umfasst die mylife CamAPS FX App und die mylife YpsoPump Insulinpumpe zur automatisierten Insulinabgabe.

Die mylife YpsoPump bietet Ihnen in Kombination mit der mylife CamAPS FX App¹ auf Ihrem kompatiblen Smartphone² ein automatisiertes Insulinabgabesystem.

 **Einfache und automatische Anpassung der Insulinabgabe** auf Grundlage der Glukosewerte des FreeStyle Libre 3 Sensors, um Unter- und Überzuckerungen zu vermeiden.

 **Diskrete und bequeme Bolusfernabgabe** gesteuert über Ihr Smartphone.

 **Bequeme Bolusvorschläge** auf Basis der Glukosewerte Ihres kontinuierlichen Glukosemesssystems.

Erfahren Sie mehr auf
www.mylife-diabetescare.com

Das CGM der nächsten Generation, abgestimmt auf Ihr Leben.



Ausgezeichnete Messgenauigkeit³ mit
Glukosewerten jede einzelne Minute.



Der **kleinste und flachste Sensor⁴**
der Welt.



Sichere Verbindung⁵ ohne
Datenlücken⁶ dank Sensor
Datenspeicherung über 14 Tage.



**Fragen Sie Ihr Diabetesteam nach FreeStyle Libre 3,
freigegeben für die Verwendung mit dem mylife Loop System
zur automatisierten Insulinabgabe.**



FreeStyle
Libre 3

Oder rufen Sie uns an:
0800 – 93 00 93*

Abbott
life. to the fullest.®

*Kostenlos aus dem österreichischen Mobilfunknetz und Festnetz. Montag-Freitag (werktags) von 08:00 bis 18:00 Uhr. Samstag (werktags) von 09:00 bis 17:00 Uhr.

CGM = kontinuierliche Glukoseüberwachung.

Medizinprodukt. Bitte die Gebrauchsanweisung genau beachten. Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich um Agenturfotos, die mit Modells gestellt wurden.

1. Bitte beachten Sie, dass Sie eine kompatible mylife YpsoPump benötigen, um die mylife CamAPS FX App für die automatisierte Insulinabgabe nutzen zu können. **2.** Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyle.Abbott, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. **3.** Alva, S., et al. Diabetes Ther. 2023 Mar 6th. doi: 10.1007/s13300-023-01385-6. Online ahead of print. **4.** Im Vergleich mit anderen von Patient:innen selbst anzubringenden Glukosesensoren. Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care. **5.** Basierend auf der Signalstärke im Dexcom G6 CGM Benutzerhandbuch und Medtronic Guardian Connect System Benutzerhandbuch. **6.** Der Alarm bei Signalverlust wird automatisch aktiviert, sobald ein Glukose-Alarm zum ersten Mal eingeschaltet wird. Der Alarm bei Signalverlust kann jederzeit aus- und wieder eingeschaltet werden.

Das Sensorgehäuse, FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen sind Marken von Abbott. mylife Loop und YpsoPump sind eingetragene Marken der Ypsomed AG. CamAPS ist eine eingetragene Marke von CamDiab Ltd. Andere Handelsmarken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Für die Nutzung des FreeStyle Libre 3 Sensors mit mylife Loop konsultieren Sie bitte das Benutzerhandbuch der mylife CamAPS FX App.

© 2023 Abbott | ADC-76526 v1.0 | Juli 2023 | sense & image