



ΜΠΟΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ¹

Μοιραστείτε εύκολα τα δεδομένα της γλυκόζης με τον
ιατρό σας μέσα από την εφαρμογή FreeStyle LibreLink²


FreeStyle
LibreLink

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FLASH


life. to the fullest.™

Abbott


1. Η σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί τη χρήση σκαρφιστήρων. 2. Η εφαρμογή FreeStyle LibreLink είναι συμβατή μόνο με ορισμένα κινητά τηλέφωνα και λειτουργικά συστήματα. Παρακαλούμε ελέγξτε τον Οδηγό συμβατότητας Κινητών Τηλεφώνων πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.

Μοιραστείτε εύκολα τα δεδομένα της γλυκόζης με τον ιατρό σας




ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΗΤΗ με την εφαρμογή FreeStyle LibreLink¹

Η λειτουργία «Σύνδεση σε ένα Κέντρο Διαβήτη» της εφαρμογής, σας επιτρέπει να διασυνδεθείτε με τον ιατρό σας και να του κοινοποιείτε αυτόματα τα δεδομένα της γλυκόζης σας μέσα από το LibreView²



ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΤΙΒΑ της γλυκόζης

Τα δεδομένα της γλυκόζης σας αποθηκεύονται αυτόματα στο LibreView, ένα σύστημα διαχείρισης στο cloud, που παρέχει στον ιατρό σας τυποποιημένες και εύκολες στην ερμηνεία αναφορές, οποιαδήποτε στιγμή, παντού

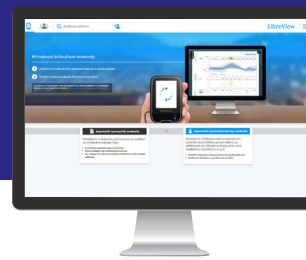

LibreView



Εύκολη σύνδεση

Η εφαρμογή FreeStyle LibreLink σας επιτρέπει να διασυνδεθείτε εύκολα με το κέντρο διαβήτη του ιατρού που σας παρακολουθεί

Αυτόματη κοινοποίηση δεδομένων

Μετά τη διασύνδεση, τα δεδομένα της γλυκόζης σας μεταφέρονται αυτόματα από την εφαρμογή στον λογαριασμό LibreView του ιατρού σας³


Πιο εποικοδομητική συζήτηση με τον ιατρό

Ο ιατρός σας έχει πρόσβαση σε αναλυτικές αναφορές γλυκόζης κατά την επίσκεψή σας, κάνοντας τη διαχείριση του διαβήτη πιο αποτελεσματική

Μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Τα δεδομένα των ασθενών δεν είναι παραγματικά.

1. Η εφαρμογή FreeStyle LibreLink είναι συμβατή μόνο με ορισμένα κινητά τηλέφωνα και λειτουργικά συστήματα. Παρακαλούμε ελέγξτε τον Οδηγό συμβατότητας Κινητών Τηλεφώνων πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή. **2.** Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος LibreView: Safari έκδοση 10.1, Internet Explorer 11, Firefox έκδοση 32 ή Chrome έκδοση 37.0 εγκατεστημένα σε H/Y που χρησιμοποιεί Mac OS X Yosemite (10.10), Windows 7 SP1, Windows 8.1 ή Windows 10 (επετειακή έκδοση). Γίνεται εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης συσκευής LibreView, ώστε να μεταφέρονται δεδομένα από συσκευές που συνδέονται με τον H/Y. Ανατρέξτε στον Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης LibreView για περισσότερες πληροφορίες. **3.** Η χρήση της εφαρμογής FreeStyle LibreLink απαιτεί εγγραφή στο LibreView.

Με την εφαρμογή FreeStyle LibreLink είναι εύκολο να μοιραστείτε τα δεδομένα της γλυκόζης σας!

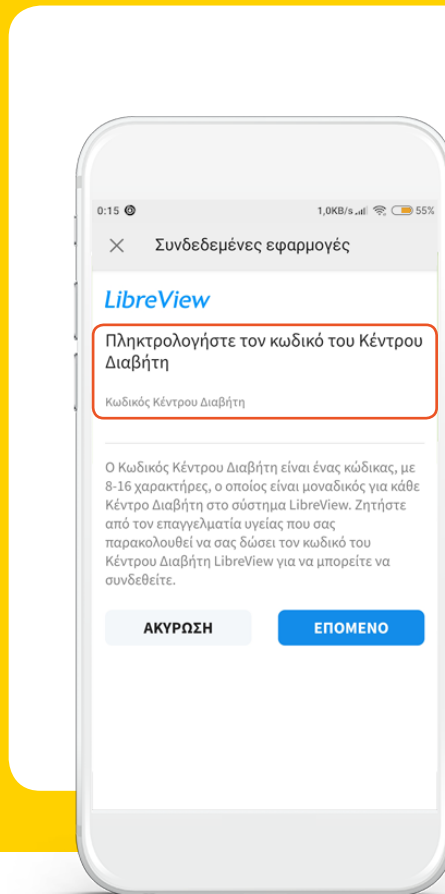

Επιλογή 1: Συνδεθείτε απευθείας με τον ιατρό σας

Ζητήστε από τον ιατρό σας να σας δώσει τον κωδικό του Κέντρου Διαβήτη του στο LibreView. Ο κωδικός είναι μοναδικός για κάθε ιατρό.


Στη συνέχεια, απλά καταχωρήστε τον κωδικό του Κέντρου Διαβήτη στην εφαρμογή FreeStyle LibreLink¹

Επιλέξτε:

Μενού > Συνδεδεμένες Εφαρμογές > Σύνδεση > Σύνδεση σε ένα Κέντρο Διαβήτη > Καταχώρηση Κωδικού Κέντρου Διαβήτη

Πατήστε **Επόμενο** και **Σύνδεση** αφού δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Κέντρου Διαβήτη του ιατρού σας

Ζητήστε από τον ιατρό σας να σας στείλει μια πρόσκληση για να μοιραστείτε τα δεδομένα της γλυκόζης σας

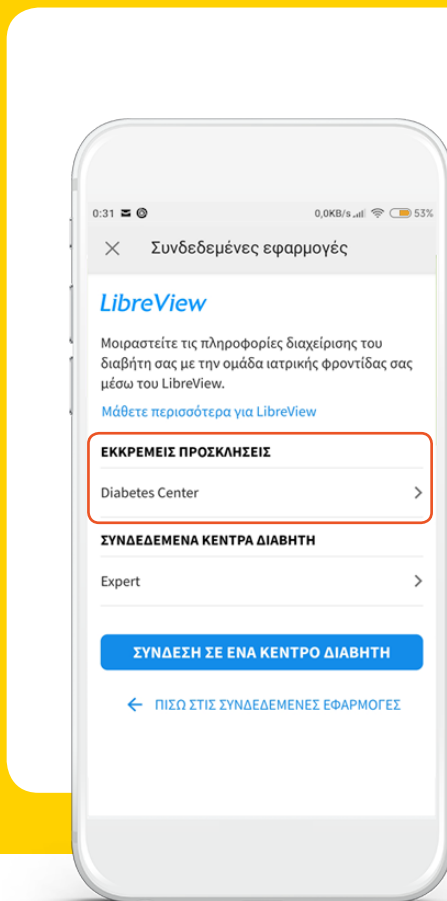

Επιλογή 2: Αποδεχτείτε την πρόσκληση του ιατρού σας


Ο ιατρός σας θα σας στείλει μια πρόσκληση για να μοιραστείτε τα δεδομένα της γλυκόζης σας. Μπορείτε να αποδεχτείτε την πρόσκλησή του με 2 τρόπους:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποδοχή Πρόσκλησης» στο email που θα λάβετε από τον ιατρό σας ή
2. Αποδεχτείτε την πρόσκληση απευθείας στην εφαρμογή FreeStyle LibreLink¹ όπως παρακάτω

Επιλέξτε:

Μενού > Συνδεδεμένες Εφαρμογές > Σύνδεση > Εκκρεμείς Προσκλήσεις > Αποδοχή

Διασυνδεθείτε με τον ιατρό σας για να κάνετε τη διαχείριση του διαβήτη πιο αποτελεσματική!

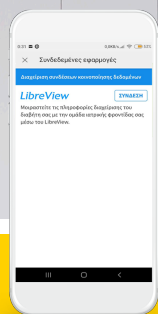

FreeStyle
LibreLink

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FLASH

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΗΤΗ

Αξιοποιείτε την εφαρμογή FreeStyle LibreLink για να μοιράζεστε αυτόματα τα δεδομένα γλυκόζης με τον ιατρό σας¹



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ

Εσείς και ο ιατρός σας μπορείτε να κάνετε πιο εποικοδομητικές συζητήσεις για τα μοτίβα και τις τάσεις της γλυκόζης σας²



LibreView

FreeStyle
LibreLink

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FLASH

Κατεβάστε σήμερα την εφαρμογή FreeStyle LibreLink και διασυνδεθείτε με τον ιατρό σας



life. to the fullest.™

Abbott

1. Η εφαρμογή FreeStyle LibreLink είναι συμβατή μόνο με ορισμένα κινητά τηλέφωνα και λειτουργικά συστήματα. Παρακαλούμε ελέγξτε τον Οδηγό συμβατότητας Κινητών Τηλεφώνων πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή. 2. Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος LibreView: Safari έκδοση 10.1, Internet Explorer 11, Firefox έκδοση 32 ή Chrome έκδοση 37.0 εγκατεστημένα σε Η/Υ που χρησιμοποιεί Mac OS X Yosemite (10.10), Windows 7 SP1, Windows 8.1 ή Windows 10 (επετειακή έκδοση). Γίνεται εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης συσκευής LibreView, ώστε να μεταφέρονται δεδομένα από συσκευές που συνδέονται με τον Η/Υ. Ανατρέξτε στον Οδηγό Γρίγορης Εκκίνησης LibreView για περισσότερες πληροφορίες.

Το σχήμα του κυκλικού αισθητήρα, το FreeStyle, το Libre και τα σχετικά εμπορικά σήματα ανήκουν στην Abbott. Άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

© 2020 Abbott. ADC-27084 v1.0 09/20