



FreeStyle Libre


FLASH SISTEM ZA SPREMLJANJE GLUKOZE

Vodnik za hiter začetek



Pregled nastavitve


Za celotna navodila za uporabo sistema in informacije glejte uporabniški priročnik.

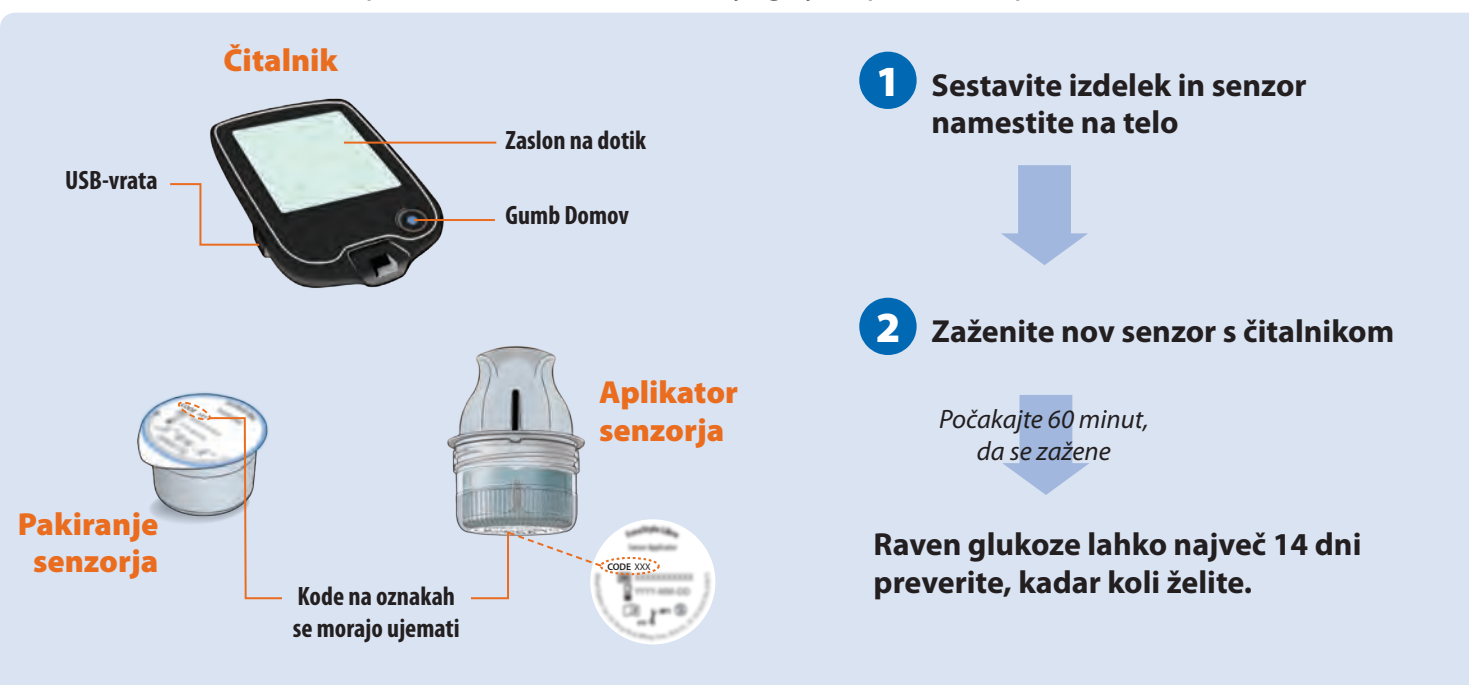

1 Sestavite izdelek in senzor namestite na telo

Uvod

1. KORAK




Izberite mesto na hrbtni strani nadlakti.
Opomba: Izogibajte se brazgotinam, madežem, strijam, izboklinam in mestom za injiciranje insulina. Da preprečite draženje kože, med aplikacijami izbirajte različna mesta. Upoštevajte svoje udobje in dejavnosti.

2. KORAK




Mesto umijte z navadnim milom, ga osušite in nato očistite z alkoholnim robčkom. Preden nadaljujete, počakajte, da se mesto osuši na zraku.

3. KORAK

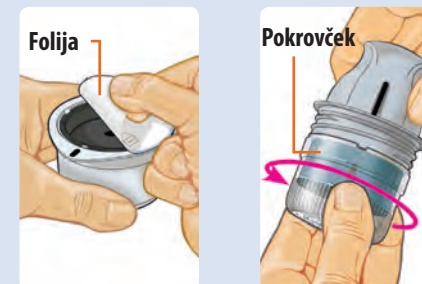


Zaporno folijo povsem odstranite s pakiranja senzorja. Z aplikatorja senzorja odvijte pokrovček.

POZOR: Kodi senzorja se morata ujemati na pakiranju senzorja in aplikatorju senzorja.




Priloga aplikatorja senzorja

4. KORAK



Temno oznako na aplikatorju senzorja poravnajte s temno oznako na pakiranju senzorja. Na trdi površini potiskajte aplikator senzorja močno navzdol, dokler se ne ustavi.

5. KORAK



Aplikator senzorja odstranite iz pakiranja senzorja.

6. KORAK




Aplikator senzorja je pripravljen na namestitev senzorja.

POZOR: Aplikator senzorja zdaj vsebuje iglo. Ne dotikajte se notranjosti aplikatorja senzorja ali pa ga vrnite v pakiranje senzorja.

Namestitev senzorja


7. KORAK



Aplikator senzorja postavite na mesto in potisnite močno navzdol, da senzor namestite.

POZOR: Aplikatorja senzorja ne potiskajte navzdol, dokler ni postavljen na pripravljeno mesto, da preprečite neželene rezultate ali poškodbe.

8. KORAK



Nežno povlecite aplikator senzorja proč od svojega telesa.

9. KORAK



Prepričajte se, da je senzor dobro nameščen.

Rabljeno pakiranje senzorja in aplikator senzorja zavržite. Glejte razdelek *Odlaganje med odpadke* v uporabniškem priročniku.



2 Zaženite nov senzor s čitalnikom


1. KORAK



Za vklop čitalnika pritisnite gumb Domov.

Opomba: Če prvič uporabljate čitalnik, sledite pozivom za nastavev datuma, časa in ciljnega razpona glukoze.

2. KORAK



Dotaknite se možnosti **Start New Sensor** (Zagon novega sensorja).

3. KORAK



Za optično branje sensorja držite čitalnik največ 4 cm (1,5 in) proč od sensorja. Senzor lahko za preverjanje ravni glukoze uporabite po 60 minutah.



3 Preverite raven glukoze

1. KORAK




Za vklop čitalnika pritisnite gumb Domov.

2. KORAK





Za optično branje sensorja držite čitalnik največ 4 cm (1,5 in) proč od sensorja.

3. KORAK



Čitalnik kaže odčitke glukoze.

Razumevanje odčitkov glukoze

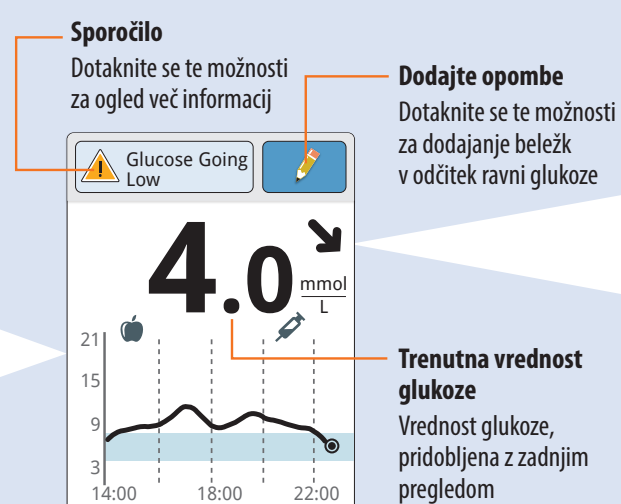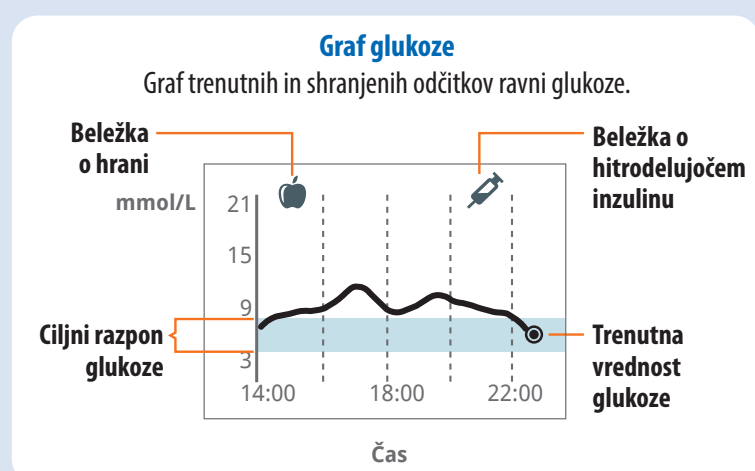

Puščica trenda glukoze
Smer gibanja glukoze.

Puščica	Kaj pomeni
↑	Raven glukoze se hitro dviga
↗	Raven glukoze se dviga
→	Raven glukoze se počasi spreminja
↘	Raven glukoze se znižuje
↓	Raven glukoze se hitro znižuje


4 Preglejte zgodovino

1. KORAK




Za vklop čitalnika pritisnite gumb Domov. Za vrnitev na domači zaslon znova pritisnite gumb Domov.

2. KORAK



Dotaknite se možnosti **Review History** (Preglej zgodovino).

3. KORAK

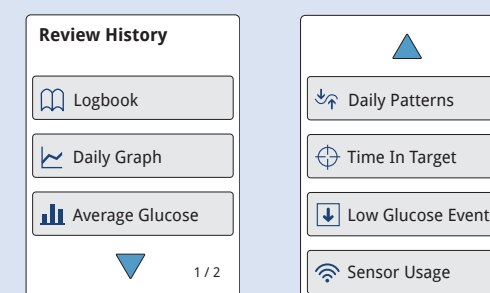

Za ogled izberite možnost.

Če ste upoštevali navodila, opisana v uporabniškem priročniku, in še vedno prihaja do težav pri nastavitvi sistema ali če opazate simptome, ki niso skladni z meritvami ravni glukoze, se obrnite na zdravstvenega delavca.

FreeStyle, Libre, and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions.
©2019 Abbott ART41054-026 Rev. A 12/19

EC REP Abbott B.V. Weeglaan 9, 2132 JD Hoofddorp, The Netherlands



CE 2797

Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road, Witney, Oxon OX29 0YL, UK

