

RILEY y el RANGO MÁGICO



Riley y el Rango Mágico

**Este libro está dedicado a todos los niños fuertes
con diabetes en el mundo. Son únicos. Son maravil-
losos. Son muy especiales.**



Riley era una hechicera fantástica.


Podía pintar cuadros con su varita con gran habilidad.





Podía volar en su escoba
y realizar trucos aéreos
con gran facilidad.

Verás, Riley tenía diabetes tipo uno. Pero mientras se mantuviera dentro de su rango mágico de glucosa[†], podía hacer toda la magia que deseara.

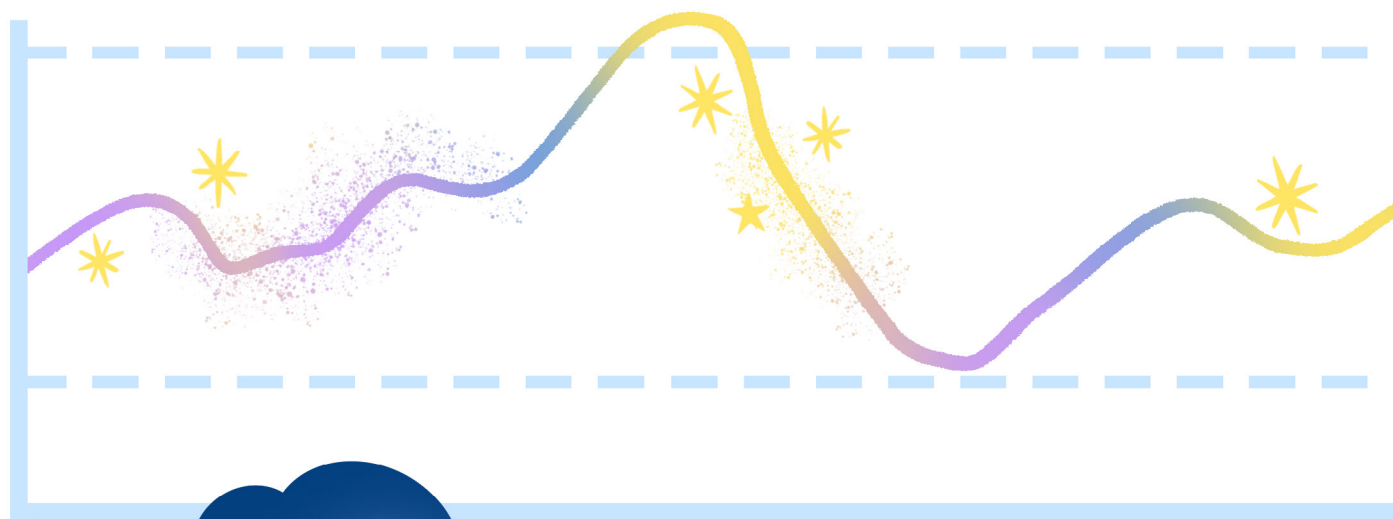



Pero había un problema.

Si los niveles de glucosa de Riley se salían de su rango mágico, sus hechizos se descontrolaban.



Una mañana, Riley estaba en su castillo mágico en el bosque.

¡Había organizado una encantadora fiesta de té con sus invitados favoritos: Susy la Salamandra, Soso el Oso, Tony el Poni, e incluso Cristal la Marsupial!



Ellos estaban disfrutando de un gran momento bebiendo té, dibujando, cantando canciones y bailando, pero entonces las cosas comenzaron a salir mal.





La guitarra comenzó a sonar sin control.



Sus invitados comenzaron a romper tazas.



¡Y las cucharas salieron volando!



“¡Por favor, hechizos, dejen de
portarse mal!”
Pero su magia no la escuchaba.



Los crayones
pintaron la pared.



Susy se subió a
bailar en la mesa.



Y a Riley le rebotó una
pelota en la cabeza. ¡La
magia estaba inestable!

¡Entonces Riley se dio cuenta de que debía estar fuera de su rango mágico[†]!



“¡Oh, no! ¿Qué haré?”, Riley lloraba.
“¿Tal vez mis niveles de glucosa están demasiado bajos? ¡Seguro estoy fuera de mi rango mágico[†]! “¡Mis hechizos están fuera de control!”

De repente, la mamá de Riley entró a su castillo mágico. Por suerte, ella tenía una alarma* que le decía cuándo los niveles de glucosa de Riley estaban demasiado altos o bajos†.



Por eso ella ya sabía que algo estaba mal.



Para asegurarse, revisó el número y vio que su nivel de glucosa estaba, como era de esperar, demasiado bajo.

Entonces le dijo a Riley: “Come esta manzana y todo se arreglará”.

Riley mordió la manzana. Los
crayones comenzaron a dibujar
líneas finas y finalmente
volvieron a la mesa.



La guitarra tocó una
suave melodía antes
de detenerse.



Susy se bajó de la mesa y los demás invitados dejaron de romper tazas, y todos volvieron a sentarse en sus sillas como si nada.

Y las cucharas cayeron al suelo con un tintineo.



El resto del día, Riley pintó cuadros con su varita con mucha habilidad.



Y realizó trucos aéreos en su escoba con gran facilidad.

Y tuvo otra fiesta de té, llena de mucha felicidad.



Y toda su magia volvió a ser buena...
lo que restó de ese día.





EL FIN

El sistema FreeStyle Libre 3 fue aprobado para uso en niños de 4 años en adelante con el sensor Libre 3, y de 2 años en adelante con el sensor Libre 3 Plus.

Las aplicaciones del sistema FreeStyle solo son compatibles con ciertos dispositivos móviles y sistemas operativos. Revise la sección de “Soporte” en nuestra página web para más información sobre la compatibilidad de dispositivos antes de utilizar las aplicaciones. Es posible que sea necesario registrarse en LibreView para poder utilizar las aplicaciones de los sistemas FreeStyle Libre.

Pueden aplicarse criterios de Medicare y otros pagadores.

* Las notificaciones de alarma solo se recibirán si en la configuración la alarma está habilitada y encendida y el sensor se encuentra a 10 metros (33 pies) del dispositivo de lectura, sin obstrucciones.

† El rango promedio es de 70-180 mg/dL. Consulte a un profesional de la salud para saber sus niveles de glucosa individuales deseados.

Información de seguridad importante

Este producto solo se vende con receta médica. Para obtener información de seguridad importante, visite la página [FreeStyleLibre.us](https://www.FreeStyleLibre.us)

La carcasa del sensor, FreeStyle, Libre y las marcas comerciales relacionadas son marcas registradas de Abbott. Otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2025 Abbott. ADC-37119 v3.0

